

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 66 del 26/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA' PENTAX ITALIA S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SULLA SONDA VIDEOECOENDOSCOPICA PENTAX MOD. EB19-J10U IN UTILIZZO PRESSO LA UOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UOC CHIRURGIA TORACICA DEGLI IFO – CIG Z32397FA3A

Esercizi/o 2023 - 503030101 Centri/o di costo 3030230

- **Importo presente Atto: € 9.464,76**

- **Importo esercizio corrente: € 9.464,76**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/161730.587

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-38-2023

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
allegato

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.1.2021 e n. 380 del 25.3.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Premesso che con determina n. 613 del 27/06/2022 è stato affidato alla società Pentax il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica "full risk" sul sistema Eus-Ebus in uso presso la UOC Chirurgia Toracica e UOSD Gastroenterologia degli IFO periodo 01.05.2022/30.04.2023;
- Considerato che con Delib. n. 689 del 19 giugno 2020 tramite adesione al Lotto 1 della gara indetta dalla Regione Lazio, è stato affidato all’ATI HC Hospital Consulting Spa-GE Medical System Italia Spa- Philips Spa il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli IFO;

- Preso atto che in data 13.12.2022 è stata fatta per il tramite della' ATI di cui al punto precedente, una richiesta d'intervento per la riparazione di una sonda videoecoendoscopica Mod. EB19-J10U collegata al sistema Ebus-Eus;
- che la sonda è stata quindi mandata in riparazione alla società Pentax Italia s.r.l., che ha comunque provveduto a inviare un'apparecchiatura sostitutiva per garantire la continuità dell'attività clinica del reparto;
- Preso atto che in data 28.12.2022 la società Pentax ha inviato il preventivo n. 5240018156 del 11.11.2022 (Allegato 1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale) in quanto riscontrava dei danni accidentali sulla stessa sonda come evidenziato nella relazione allegata (Allegato 2) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale che pertanto non risultano ricompresi nel contratto di assistenza in essere;
- Considerato che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ripristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano tra le spese obbligatorie sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, indispensabile per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione di pubblico servizio;
- Acquisito che l'importo complessivo pari a € 7.758,00 oltre oneri di legge risulta essere in linea con precedenti interventi pertanto è ritenuto congruo;
- Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza al fine di utilizzare nella loro piena funzionalità le apparecchiature di cui trattasi e consentire la continuità delle attività cliniche;
- Ravvisato l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per il quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- Tenuto conto che la manutenzione di cui trattasi può essere eseguita solamente dalla società Pentax in quanto fornitrice del bene e affidataria della manutenzione e assistenza tecnica della strumentazione di cui trattasi;

- Dato atto** che la complessiva spesa di € 7.758,00 + iva (22%) ovvero pari a € 9.464,76 iva inclusa, grava sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2023;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla società Pentax Italia s.r.l. dei lavori di manutenzione correttiva sulla sonda videoecoendoscopica Mod. EB19-J10U in utilizzo presso la UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e UOC Chirurgia Toracica degli IFO – CIG Z32397FA3A
- Registrare la spesa € 7.758,00 + iva (22%) ovvero pari a € 9.464,76 iva inclusa sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2023;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenziò n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

Ad 1

Preventivo di riparazione

Data 27/12/22
* Nr. documento 5240018156
* Nr. cliente 11200163
Pagina 1
Contatto Davide Rai
Nr. di telefono
Nr. fax

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA (RM)

* Indicare questi riferimenti nelle successive comunicazioni

Vs. riferimento N.083_22 DEL 14/12/22

Descrizione	Nr. seriale	Qtà	Prezzo	Scon. %	Importo EUR
[EB19-J10U] Video Ecobroncoscopio EBUS HD (J10	A120061				
We have detected the following defects:					
Ricerca guasto US					
Scheda CCD infiltrati					
Gruppo multipoli infiltrato					
Tube inserzione danneggiato da trauma					
Cavo connettore ecografico usurato					
Guaina distale da sostituire					
Test isolamento sonda eco					
Ricambi Sostituiti:					
CANALE PALLONCINO EB-1970UK		1	79,00	100,00	
GUAINA EB-2000 FB-19TX		1	95,00	100,00	
CAUTION LABEL		1	21,00	100,00	
INSERTION FLEXIBLE TUBE		1	3.010,00		3.010,00
CILINDRO ASTA LCB SERIE 70/80		1	152,00	100,00	
Light Guide Prong		1	138,00	100,00	
OPERATION CHANNEL		1	250,00	100,00	
O-RING SPECIAL FOR US CONNECTOR		1	21,00	100,00	
CONS - O-RING SPECIAL FOR COVER LG		1	8,00	100,00	
CONS - O-RING IMPUGNATURA EB-15/1970K		1	5,00	100,00	
SUB CONNECTOR J10U		2	132,00	100,00	
US Connector Cable		1	1.050,00	100,00	
PCB For CCD K4/PAL		1	1.621,00		1.621,00
MULTIPOLI SERIE 90		1	940,00		940,00
CONS - O-RING CONNESSIONE 70/80		1	11,00	100,00	
ConneSSIONe video infiltrata					
Body infiltrato					
Addebito forfetario per Sanificazione Endo-Flex		1	65,00		65,00
O-Ring, Viti e Consumabili		1	55,00		55,00
Verifiche di Sicurezza Elettrica		1	77,00		77,00
Valutazione Immagine Ecografica		1	70,00		70,00
Ore di lavoro		32	120,00	50,00	1.920,00

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenziò n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

Preventivo di riparazione

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA (RM)

Data 27/12/22
* Nr. documento 5240018156
* Nr. cliente 11200163
Pagina 2
Contatto Davide Rai
Nr. di telefono
Nr. fax

* Indicare questi riferimenti nelle successive comunicazioni

Descrizione	Nr. seriale	Qtà	Prezzo	Scon.%	Importo EUR
Subtotale					7.758,00
Senza spese di spedizione					
IVA 22% su 7.758,00 EUR					1.706,76
Totale					<u>9.464,76</u>

Condizioni pagamento
60 gg d.f. Rimessa Diretta (Bonifico)

Metodo di spedizione
Franco

Spedizioniere
BRT S.P.A.
Servizi spedizioniere

Vi informiamo che i prezzi esposti non sono oggetto di trattativa perchè stimati al miglior costo al cliente con formula uguale per tutta Italia.

IVA: a Vostro carico
Validità dell'offerta: 60 giorni

Consegna: entro 30 giorni lavorativi
Garanzia: 6 mesi per componenti sostituiti

OVE APPLICABILE E SE DISPONIBILE VI PREGHIAMO DI SEGNALARCI IL CODICE - CIG/CUP.

Con l'accettazione del preventivo acconsentite irrevocabilmente allo smaltimento o al riutilizzo delle parti di ricambio sostituite da parte di PENTAX. Nel rispetto della legge sulla privacy in caso di invio di processori per la riparazione o l'assistenza, è obbligatorio da parte vostra cancellare tutti i dati dei pazienti prima dell'invio dello strumento.

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenziò n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

Preventivo di riparazione

Data 27/12/22
* Nr. documento 5240018156
* Nr. cliente 11200163
Pagina 3
Contatto Davide Rai
Nr. di telefono
Nr. fax

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA (RM)

* Indicare questi riferimenti nelle successive comunicazioni

Per piacere confermare l'ordine, firmando questo modulo.

- Per piacere eseguire la riparazioni secondo il preventivo.
- Per piacere rendere i ricambi utilizzati.
- Per piacere non riparare.
- Per piacere inviare un preventivo per un nuovo strumento.
- Per piacere rendere lo strumento (potrebbe essere parzialmente smontato).
Vi addebiteremo 149,00 EUR per costi di trasporto.
- Per piacere smaltire lo strumento.

Luogo: _____ Data: _____ Firma: _____

All 2

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenziò, 16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

Milano, 28.12.2022

Spett.le


Service Order 5240018156 MS/dr

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANNESI 53
00144 ROMA

Oggetto: Riparazione Sonda Videoecoendoscopica Pentax mod. EB19-J10U matr. A120061



A seguito di una verifica eseguita sullo strumento in oggetto vi informiamo di aver riscontrato quanto segue:

- **Schiacciatura tubo d'inserzione**
- **Infiltrazione connessione video e gruppo manopole**

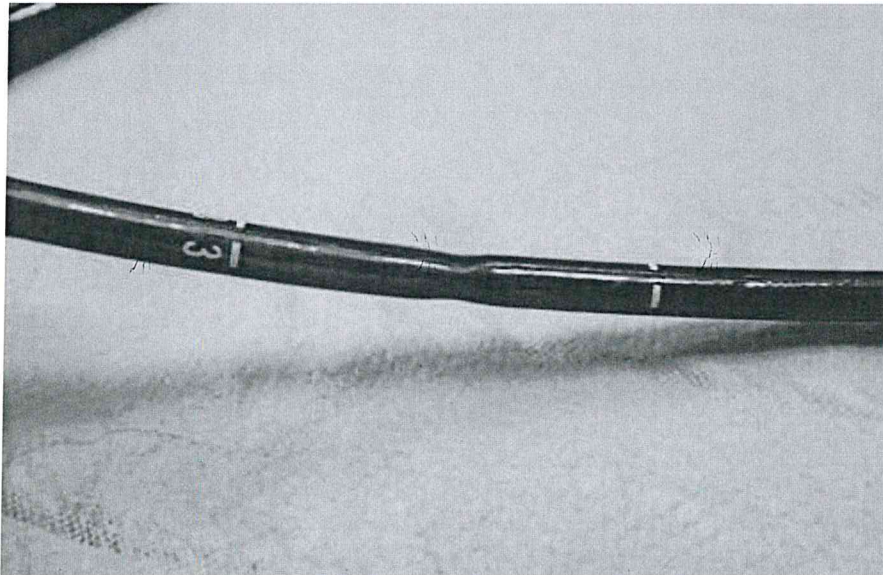


PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzi, 16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

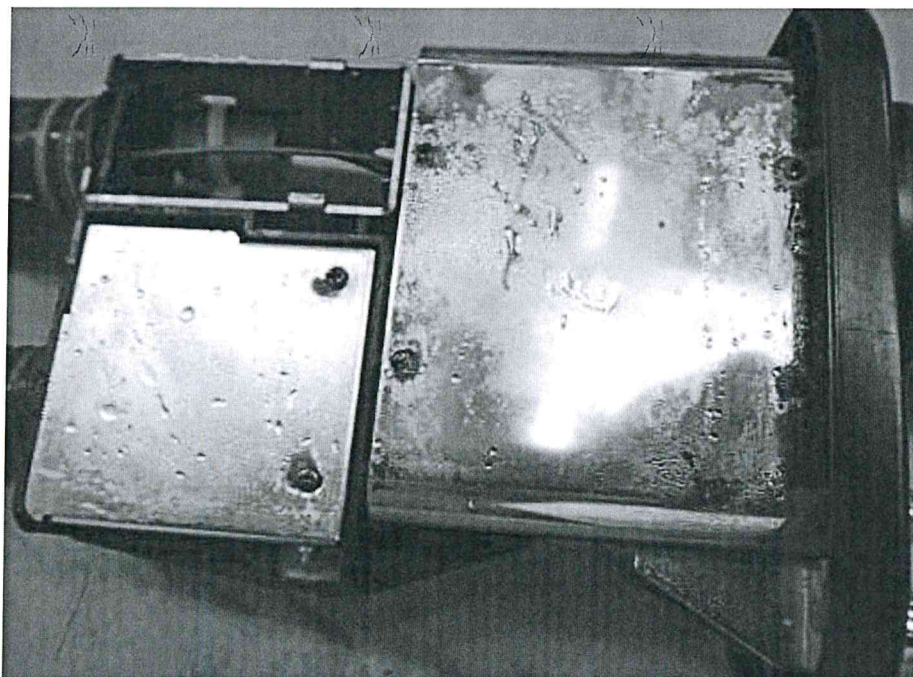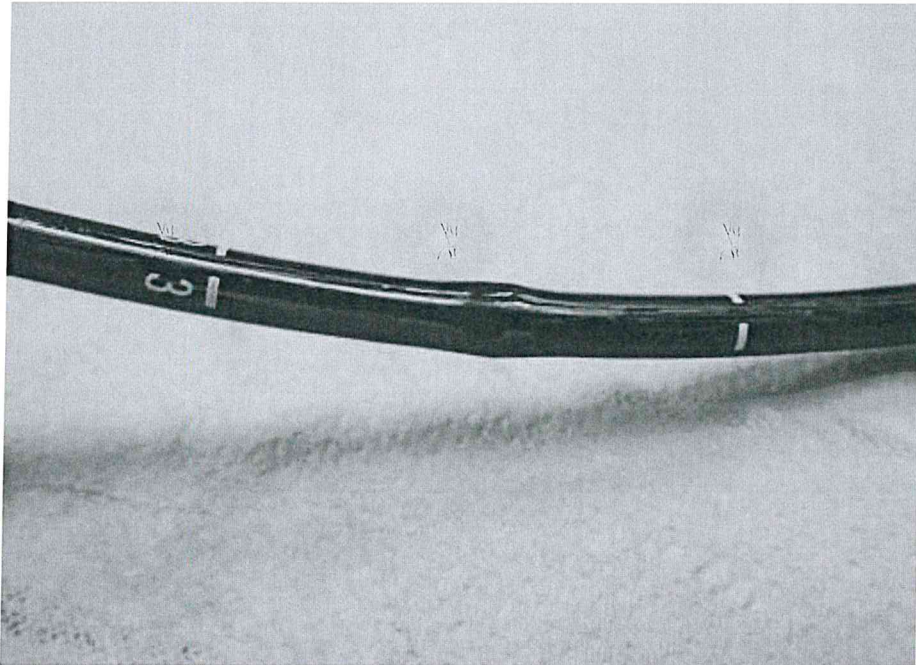

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzio,16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

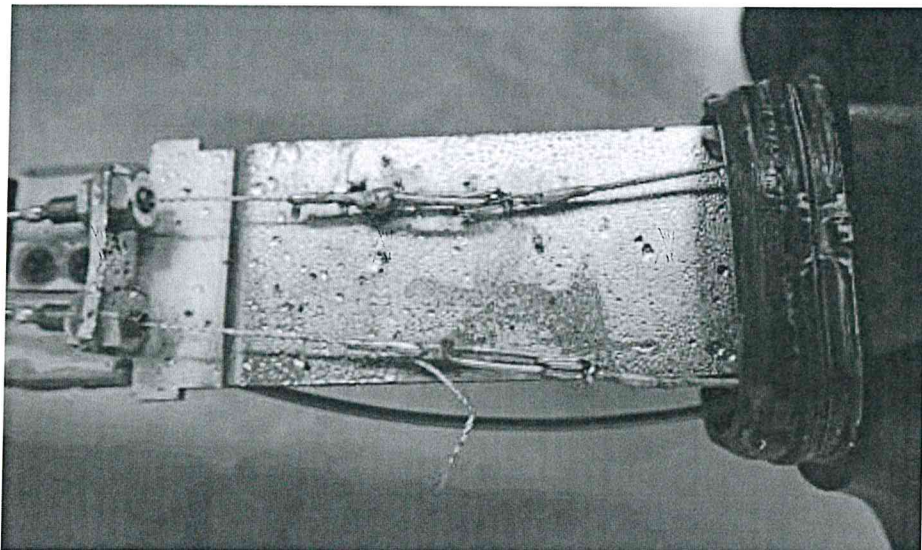

Vi informiamo che i danni riscontrati sono esclusi dal contratto di full risk con voi in essere, pertanto provvederemo al solo addebito delle componenti danneggiate mentre i restanti ricambi verranno assorbiti totalmente da Pentax.

Vi ricordiamo che l'infiltrazione di liquido è evitabile eseguendo il test di tenuta con la periodicità e le modalità indicate sul manuale d'uso dell'apparecchiatura assicurandosi che la Lavaendoscopi in uso effettui tale verifica durante il lavaggio.

Vi chiediamo cortesemente di sensibilizzare il personale sanitario all'utilizzo e alla movimentazione della strumentazione Pentax.

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità e in attesa di un vostro gradito riscontro porgiamo distinti saluti.

PENTAX Italia S.r.l.
Con Unico Socio
Massimiliano Sangregorio
Service Sales Manager